「2025/2026 學年-校舍興建與修葺及設備購置(化學室設備添置)」詢價內容

14.3.1 M25-0005868286 化學室設備添置			
序號	產品名稱	單位	數量
1	**電子天平** 規格：2000g x 0.1g 型號：YF2001 牌子：YF	項	4
2	**紫外可見機專用石英比色管** 規格：LIGHTPATH, England UV silica cell 型號：TYPE1/10MM/Q	項	2
3	**T3 milli-q Progard 純水儀濾芯** 規格：Progard, USA T3 Pretreament pack milli-q 型號：PR0G000T3 牌子：Millipore	項	1
4	**原子堆積模型** 規格：(合共 14 個模型，其中 11 個原子堆積模型及 3 個物質粒子堆積模型) 11 個原子堆積模型，65mm 透明塑料立方體盒或 52x62mm(H)，包含簡單立方體，三角晶系，氯化鈉，體心立方 a，體心立方 b,面心立方，八面體，四面體，立方晶格，石墨，六方最密堆積; 3 個物質粒子堆積模型：包含氣態，液態，固態模型 set of 3 models"	項	2
5	**真空泵** 型號：循環水真空泵 WJ-15 型 牌子：Sibata	項	1
6	**純水儀 UV 紫外殺菌燈** 型號：ZMQUVLP01 牌子：Millipore	項	1
7	**Dipak Long** 規格：3.2L 樹脂 型號：CPDI000L1 牌子：Millipore	項	1
8	**10” 3 Micron cartridge** 型號：JMHKF1L301 牌子：Millipore	項	10
9	**Q-pak tex 濾芯** 型號：QPAK00TEX 牌子：Millipore	項	1
10	**Millipak Express 40 濾芯** 型號：MPGP04001 牌子：Millipore	項	1
11	**UV 分光光度計 激發燈** 型號：S80 Double Beam Scanning 牌子：Biochrom	項	1
12	**離子/pH 檢測計 pH 電極** SevenCompact pH/Ion Bench Meter S220-u Mix 牌子：Mettler Toledo	項	1
13	**離子/ph 檢測計 離子活度電極** 型號：SevenCompact pH/Ion Bench Meter S221-u Mix 牌子：Mettler Toledo	項	1
14	**化學計算機數據采集處理系統傳感器（對應初二初三高一高二化學課本的教學儀器）** 規格： 電化學分析：含 pH 傳感器（測量酸鹼度）、電導率傳感器（探究離子濃度）、離子選擇性電極 光學與濃度分析：含色度計（比色法測濃度）、溶解氧傳感器 成分檢測：含氣體傳感器（CO_2、O_2、H_2、揮發性有機氣體等等）	項	5

報價表範本：(須提供產品詳細內容)

14.3.1 M25-0005868286 化學室設備添置					
項	產品名稱	數量	單位	單價 (澳門幣)	總價 (澳門幣)
1	電子天平	4	項		
2	紫外可見機專用石英比色管	2	項		
3	T3 milli-q Progard 純水儀濾芯	1	項		
4	原子堆積模型	2	項		
5	真空泵	1	項		
6	純水儀 UV 紫外殺菌燈	1	項		
7	Dipak Long	1	項		
8	10” 3 Micron cartidge	10	項		
9	Q-pak tex 濾芯	1	項		
10	Millipak Express 40 濾芯	1	項		
11	UV 分光光度計 激發燈	1	項		
12	離子/pH 檢測計 pH 電極	1	項		
13	離子/ph 檢測計 離子活度電極	1	項		
14	化學計算機數據采集處理系統傳感器（對應初二初三高一高二化學課本的教學儀器）	5	項		
合計金額(MOP):					

附圖 ：

序號 1：電子天平

序號 2：紫外可見機專用石英比色管

序號 3：T3 milli-q Progard 純水儀濾芯

序號 4: 原子堆積模型

序號 5：真空泵

序號 6：純水儀 UV 紫外殺菌燈

序號 7：Dipak Long

序號 9：Q-pak tex 濾芯

序號 10：Millipak Express 40 濾芯

序號 11：UV 分光光度計 激發燈

序號 12 及 13：離子/pH 檢測計 pH 電極及離子活度電極
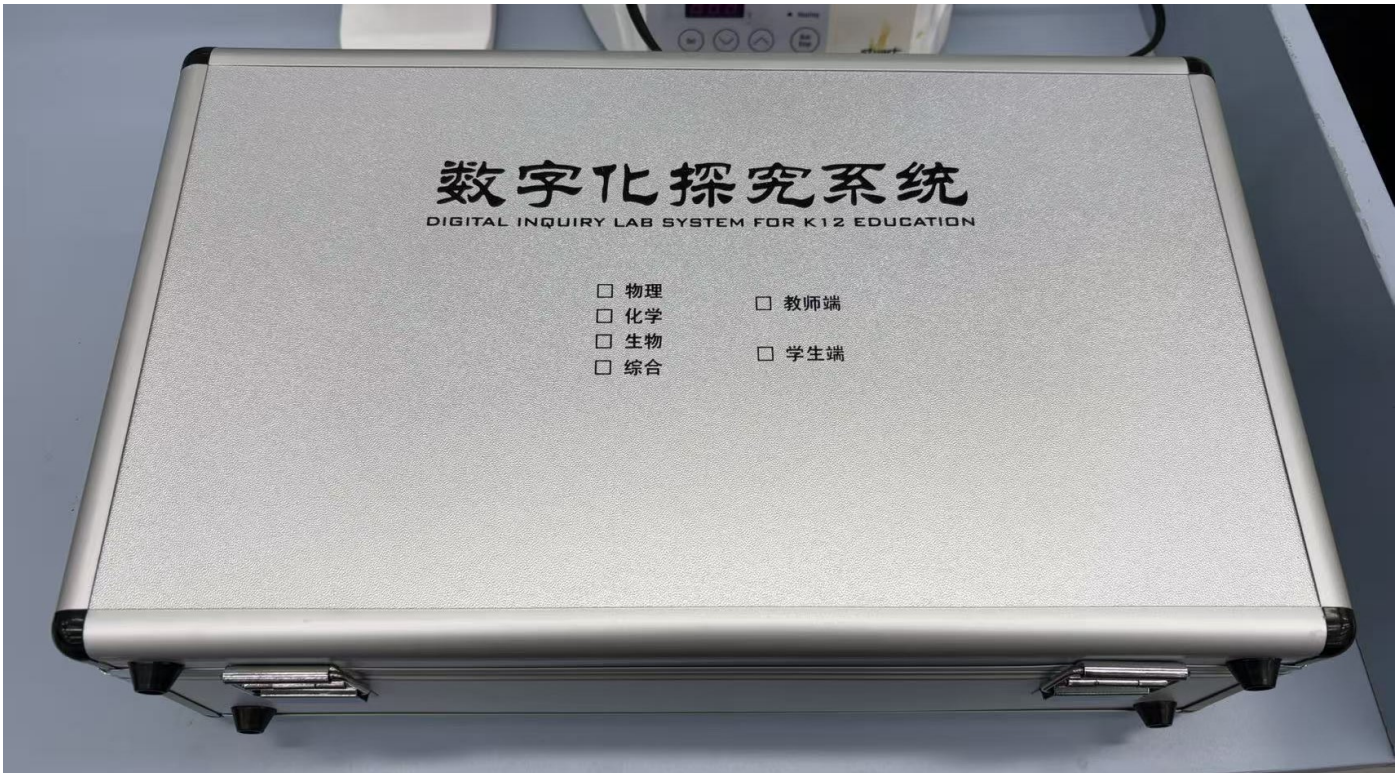
序號 14：化學計算機數據采集處理系統傳感器（對應初二初三高一高二化學課本的教學儀器）